

## นิพนธ์ต้นฉบับ

# การประเมินผลคุณสมบัติเทคนิควิเคราะห์เม็ดกลบิน โดยวิธีแอลคาไลน์ยีมาติน ซึ่งไม่ใช้สารไฮยาในด์

เทียนชัย ใจศรีราษฎร์\*  
แม่น ชัยพิพัฒน์\*\*

**Chaiyases T, Chaipipat M. An evaluation of hemoglobin determination by alkaline hematin with non-cyanide reagent. Chula Med J 1988 Oct; 32(10) : 879 - 883**

*Performance characteristics of hemoglobin assayed by alkaline hematin with non ionic detergent were studied. The standard calibration graph was linear from 8.10 to 24.3 gHb/dl. The day to day precision dose profile at hemoglobin concentrations of 4.73, 16.02 and 23.66 gHb/dl were 5.23, 1.87 and 1.76 % CV, respectively (n = 20). The average percent recovery was 98.00 %. Results by the proposed method (Y) correlated well with those by the hemiglobincyanide method (X) : r = 0.985; Y = 0.97X + 0.28; n = 294. Moreover by the method comparison study, hemoglobin values estimated by the two methods were not significantly different. Therefore, the performances of this hemoglobin determination, evaluated may be acceptable for routine clinical services.*

Reprint request : Chaiyases T, Department of Medical Technology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10500, Thailand.

Received for publication. March 4, 1988.

\* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\* นิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ความเข้มข้นของเอโนโกลบินในเลือด วิธีที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด คือวิธีไซยานเมติโนโกลบิน (cyanmethemoglobin) หรือเอมิโกลบินไซยาไนด์ (hemiglobincyanide)<sup>1-2</sup> ซึ่งยังมีข้อเสียบางประการคือ น้ำยา วิเคราะห์มีสารไซยาไนด์ เป็นสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางปาก หรือเมื่อเท่าน้ำยาที่ใช้แล้วลงในอ่างน้ำทิ้ง ถ้ามีการดูดซึ่งด้วยทำให้เกิดไอของไฮโดรเจนไซยาไนด์ระเหยขึ้น อาจเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจ นอกจากนั้นน้ำยาวิเคราะห์มีความไวต่อแสง และปฏิกิริยาทางพิสิกส์บางอย่าง<sup>(3)</sup> จึงทำให้คุณสมบัติในการเกิดสีลดลง และการสร้างกราฟมาตรฐานใช้สารละลายไซยาน-เอมิโกลบินสำเร็จรูปในการปรับเครื่องเทียบสี<sup>(4)</sup> จึงกล่าวได้ว่า สารละลายมาตรฐานไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิเคราะห์ที่มีดีเจรา กับเลือดผู้ป่วย อีกประการหนึ่งเวลาที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาของเอโนโกลบินชนิดต่างอนุพันธ์กัน มีความแตกต่างกัน เพราะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนควรของวิธีเอโนโกลบินเป็นไซยานเอมิโกลบินอยู่ระหว่าง 95-120 นาที<sup>(5, 6)</sup> ในปี ค.ศ. 1984 Zander และคณะ<sup>(7)</sup> เสนอน้ำยาวิเคราะห์ความเข้มข้น เอโนโกลบินในเลือดโดยวิธีไม่ใช้สารไซยาไนด์เรียกว่า AHD - 575 ซึ่งหมายถึง alkaline hematin with detergent วัดค่าการคุณลักษณะที่ 575 นาโนเมตร แต่เพิ่มสาร non - ionic detergent ลงในน้ำยาวิเคราะห์ ทำให้น้ำยาวิเคราะห์มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป คือความไวในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น สิ่งที่เกิดและน้ำยาไม่ความคงทนมากขึ้น และมีการคุณลักษณะที่ 575 นาโนเมตร ผู้รายงานได้ใช้คลอร์โอเอมิน (chlorohaemin) ซึ่งยังไม่มีจำหน่ายทั่วไป มาเตรียมเป็นสารละลายมาตรฐาน<sup>(8)</sup> จึงเป็นการยกที่ห้องปฏิบัติการทั่วไป จะหมายใช้ได้

การวิจัยครั้งนี้ ได้ประเมินผลคุณสมบัติของวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นเอโนโกลบินในเลือด วิธี alkaline hematin D - 575 โดยใช้เม็ดเลือดแดงแตกตัว (hemolysate) และเปรียบเทียบค่าเอโนโกลบินมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กด้วยวิธีใช้สีเพอร์โตรซีน<sup>(9)</sup> เป็นสารละลายน้ำมารฐานแทนคลอร์โอเอมิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลคุณสมบัติ ด้านการปฏิบัติ เพื่อนำวิธีการนี้มาใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

## วัสดุและวิธีการ

- การวิเคราะห์เอโนโกลบินวิธีเอมิโกลบินไซยาไนด์ ให้วิธีของ Kampen และ Zijlstra<sup>(2)</sup> ซึ่งเป็นวิธีเปรียบเทียบ และวิธี AHD - 575 ให้วิธีของ Zander และคณะ<sup>(7)</sup> ซึ่งเป็นวิธี

ที่จะปรับปรุงและประเมินผล

### 2. สารเคมีและน้ำยา

- สารเคมีที่ใช้เชิงนิยม Analytical Reagents (AR grade)

- น้ำยาวิเคราะห์ความเข้มข้นเอโนโกลบิน วิธี Hemiglobin cyanide เตรียมตามวิธีของ Kampen และ Zijlstra<sup>(2)</sup>

- สารละลายมาตรฐานเอโนโกลบิน ใช้เม็ดเลือดแดงแตกตัว (hemolysate) ซึ่งหาค่าเอโนโกลบินโดยการวิเคราะห์เหล็กตามวิธีของ จันทนี ไชยเศรษฐ และ คณะ<sup>(9)</sup> มีค่าความเข้มข้น 8.10, 12.15, 16.20, 20.25 และ 24.30 g Hb/dL ตามลำดับ

- น้ำยาวิเคราะห์ความเข้มข้นเอโนโกลบินวิธี AHD - 575<sup>(7)</sup>

sodium hydroxide	4 g
triton X - 100	25 mL
ละลายในน้ำกลั่นและเจือจากจนครบ	1 ลิตร

- การวิเคราะห์ความเข้มข้นเอโนโกลบินในเลือด วิธี AHD - 575 ทำโดยคุณลักษณะที่เอโนโกลบินแต่ละความเข้มข้น (ข้อ 2.3) ปริมาตร 0.02 mL ใส่ในน้ำยาวิเคราะห์ (ข้อ 2.4) ปริมาตร 3 mL ในแต่ละหลอดทดลองที่เตรียมไว้แล้ว และเติมน้ำยาวิเคราะห์ในหลอดเปล่า อีกหลอดหนึ่งเพื่อใช้เป็น blank ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที นำไปวัดค่าการคุณลักษณะที่ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร โดยใช้หลอด blank ปรับศูนย์ นำค่าการคุณลักษณะของสารละลายมาตรฐานแต่ละหลอด และความเข้มข้นเอโนโกลบิน ไปสร้างกราฟมาตรฐาน แล้วนำค่าการคุณลักษณะของแต่ละหลอดที่วัดได้ไปอ่านค่าในหน่วย g Hb/dL

- เครื่องมือ ใช้สเปกโตรโฟโตเมตร์ Digispec ของบริษัท Helena Laboratories สาธารณรัฐอเมริกา

- ใช้เลือดที่จะจากหลอดเลือดดำ ใส่สารกันเลือดแข็ง EDTA จากผู้ป่วยนักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 294 ตัวอย่าง ใช้สำหรับเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ 2 วิธี

- สถิติวิเคราะห์ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), สัมประสิทธิ์แห่งการกระจาย (coefficient of variation, CV%), สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient), ความถดถอยเชิงเส้นตรง (least squares regression analysis), และ student t - test.

## ผลและวิจารณ์

ได้ประเมินผลคุณสมบัติด้านการปฏิบัติ (performance characteristics) ของเทคนิคิควิเคราะห์ความเข้มข้นซีโนโกลบิน วิธี AHD - 575 ได้ผลดังนี้

1. ความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน (linear range) มีความเป็นเส้นตรงตั้งแต่ความเข้มข้น 8.10 จนถึง 24.3 gHb/dL

2. ความเที่ยงตรง (precision) โดยการวิเคราะห์

เลือดตัวอย่างเดียวกันซ้ำหลายครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1 การวิเคราะห์ซ้ำในชุดการทดลองเดียวกัน (intra-assay precision) ที่ระดับต่ำ ระดับปกติ และระดับสูงมีค่า % CV เท่ากับ 5.23, 1.87 และ 1.76 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ซ้ำต่างชุดการทดลอง (inter - assay precision) โดยใช้น้ำเลือดที่แข็งไว้ ที่ระดับต่ำ ระดับปกติ และระดับสูง มีค่า % CV เท่ากับ 5.51, 2.25 และ 3.64 ตามลำดับ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

**Table 1** Precision study of blood hemoglobin by AHD - 575 method

level	n	gHb/dL	S.D.	CV %
within day assay				
low	20	4.73	0.248	5.23
normal	20	16.02	0.299	1.87
high	20	23.66	0.416	1.76
day-to-day assay				
low	10	6.32	0.348	5.51
normal	10	12.65	0.285	2.25
high	10	18.25	0.644	3.64

3. ความแม่นยำ (accuracy) ได้ศึกษาความคลาดเคลื่อนโดย

3.1 การศึกษาเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์เลือดตัวอย่างเดียวกัน (method comparison study) โดย 2 วิธี โดยเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์วิธี AHD - 575 กับ วิธี เอมิโกลบินไชยาไนด์ ซึ่งเป็นวิธีแนะนำหรือวิธีเปรียบเทียบ<sup>(2)</sup> จำนวน 294 ราย ช่วงค่าที่ศึกษาตั้งแต่ความเข้มข้น 5 ถึง 22 gHb/dL ค่าสมการความถดถอยเชิงเส้นตรง  $Y = 0.97X + 0.28$  ค่า  $r = 0.985$ ,  $p < 0.001$  ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1 จากค่าจุดตัดแกน  $Y$  ( $Y$  intercept) ที่ศึกษาแสดงว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนประภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในเทคนิคิควิเคราะห์ชนิดค่าคงที่ (constant systematic error) = 0.28 และจากค่าความชัน (slope = 0.985) แสดงว่าวิธีนี้มีความคลาด

เคลื่อน ประภาพที่เกิดเป็นประจำในเทคนิคิควิเคราะห์ชนิดค่าเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้น = 1.5% (proportional systematic error) เมื่อนำค่าซีโนโกลบินของเลือด 294 ตัวอย่าง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 5-22 gHb/dL ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทั้งสองเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติ t-test พบร่วมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าวิธี AHD - 575 ให้ค่าวิเคราะห์แม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี เอมิโกลบินไชยาไนด์<sup>(10)</sup>

3.2 การศึกษาค่าการวิเคราะห์กลับคืน (recovery study) โดยการเพิ่มปริมาณรน้ำเลือด เพื่อให้มีความเข้มข้น 4 ระดับนำมาระยะห์ค่ากลับคืน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 ได้ค่าเฉลี่ย % recovery = 98.00% (range 92 - 102%)<sup>(10)</sup>

**Table 2** Recovery study with proposed method

No.	concentration assayed (gHb/dL)	concentration added (gHb/dL)	concentration recovered	% recovery
1	5.50	baseline	-	-
2	10.56	5.50	5.06	92.00
3	16.50	11.00	11.00	100.00
4	22.30	16.50	16.83	102.00
			average	98.00

AHD - 575  
g Hb/dL

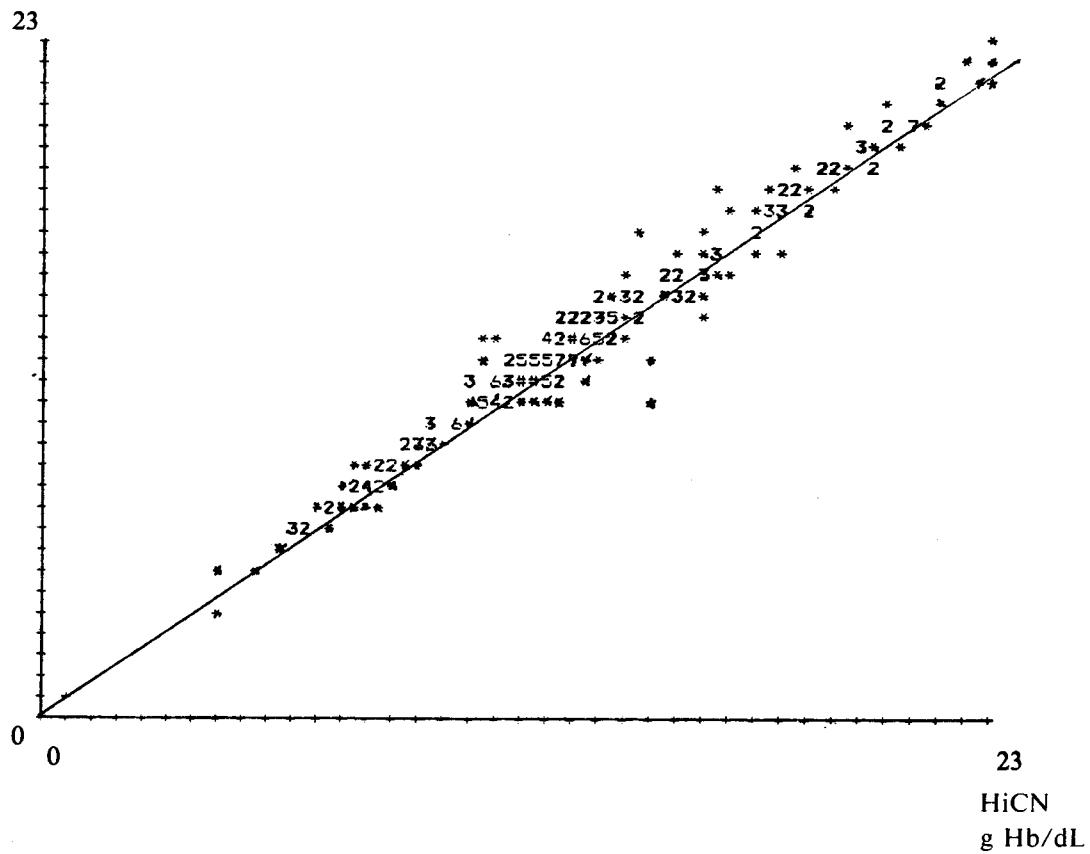


Figure 1 Correlation analysis between AHD - 575 (X) and HiCN (Y)

จากการวิจัย เมื่อใช้หลักการประเมินผลคุณสมบัติ เทคนิคิวเคราะห์ ของการวิเคราะห์ซีโมโนโกลบิน โดยวิธี AHD - 575 จะเห็นว่าเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปได้ดี สามารถเตรียมน้ำยาวิเคราะห์ได้ง่ายเก็บไว้ได้นานมากกว่า 1 ปี และมีราคาถูก โดยมีค่าใช้จ่ายต่อรายประมาณ 0.6 สถานท์แม้จะมีความไม่แน่นอนในการซึ่งน้ำหนักหรือตวงวัดปริมาตรของสารเคมีทั้งสองน้ำองก์ตาม

การปรับปรุงวิธีการสร้างกราฟมาตรฐาน โดยเปลี่ยนจากการใช้ Chlorohaemin<sup>(8)</sup> ซึ่งยังไม่มีผลิตขายแพร่หลายทั่วไป และผู้วัดจะต้องนำตากผลึกใหม่เพื่อทำให้บริสุทธิ์ ขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยาก มาใช้สารละลายน้ำตาลมาตรฐานซีโมโนโกลบิน ที่เตรียมขึ้นเอง โดยวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กใน hemolysate ที่เสนอโดย จันทน์ไชยเครชชู และคณะ<sup>(9)</sup> จึงเป็นวิธี

ที่ทำให้สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ปริมาณซีโมโนโกลบินในเลือด โดยวิธี AHD-575 มาใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปได้

### สรุป

การวิเคราะห์ปริมาณซีโมโนโกลบินในเลือดโดยวิธี AHD-575 ให้กราฟมาตรฐานที่มีความเป็นเส้นตรงถึง 24.3 gHb/dL มีค่า within day assay precision ที่ระดับซีโมโนโกลบิน 4.73, 16.02 และ 23.66 gHb/dL เท่ากับ 5.23, 1.87 และ 1.76% CV ตามลำดับ ( $n = 20$ ) และ day to day precision ที่ระดับซีโมโนโกลบิน 6.32, 12.65 และ 18.25 gHb/dL เท่ากับ 5.51, 2.25 และ 3.64% CV ตามลำดับ ( $n = 10$ ) เมื่อเปรียบเทียบวิธีนี้ (Y) กับวิธีเอมิโนโกลบินไชยาในด์ (X) พบร่วมความสัมพันธ์กันดังนี้  $r = 0.985, Y = 0.97X + 0.28, n = 294$  ที่ระดับซีโมโนโกลบิน 5 - 22 gHb/dL

การศึกษาเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์เลือดตัวอย่างเดียวกัน โดยวิธีทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วิธีการนี้ วิเคราะห์ความเข้มข้นของชีโม-

โกลบินในเลือดได้ดี โดยไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานต่อการสัมผัสกับสารพิษไวชาไนต์

## อ้างอิง

1. Drabkin DL, Austin JH. Spectrophotometric studies; spectrophotometric constants for common hemoglobin derivatives in human, dog, and rabbit blood. *J Biol Chem* 1932 Nov; 98 (11) : 719-733.
2. Kampen EJ van, Zijlstra WG. Standardization of hemoglobinometry. II. The hemiglobin-cyanide method. *Clin Chim Acta* 1961 Jul; 6: 538-544
3. Weatherburn MW, Logan JE. The effect of freezing on the potassium ferricyanide-potassium cyanide reagent used in the cyanmethemoglobin procedure for hemoglobin determination. *Clin Chim Acta* 1964 Jun; 9 : 581 - 584
4. Vanzetti G., Franzini C. Stable hemoglobin compounds in concentrated solution as reference for hemoglobinometry. *Clin Chim Acta* 1969 Jun ; 24 : 417 - 421
5. Kampen EJ van, Zijlstra WG. Determination of hemoglobin and its derivatives. *Adv Clin Chem* 1965; 8 : 141-187
6. Rodkey FL. Kinetic aspects of cyanmethemoglobin formation from carboxyhemoglobin. *Clin Chem* 1967; Jan 13 (1) : 2-5.
7. Zander R, Lang W, Wolf HV. Alkaline haematin D-575, a new tool for the determination of haemoglobin as an alternative to the cyanhaemoglobin method. I. Description of the method. *Clin Chim Acta* 1984 Jan; 136(1):83-94
8. Wolf HU, Lang W, Zander R. Alkaline haematin. D-575, a new tool for the determination of haemoglobin as an alternative to the cyanhaemoglobin method. II. Standardisation of the method using pure chlorohaemin. *Clin Chim Acta* 1984 Jan ; 136(1) : 95-104
9. จันกนี ไซย์เครชฐ, เทียนชัย ไซย์เครชฐ, บุญชัย วงศ์สกิดวิไลรุ่ง. ประเมินผลคุณสมบัติวิเคราะห์สารเหล็กในชีโมโกลบินในเลือด โดยปฏิกิริยา กับสีเฟอร์โรซีน : แนะนำวิธีเตรียมสารละลายมาตรฐานชีโมโกลบินขึ้นใช้เองในห้องปฏิบัติการ. วิชาการนักเวชสาร ๒๕๓๑ มกราคม ; ๓๒ (๑) : ๓๗-๔๒
10. สมพงษ์ จิราภรณ์. หลักการประเมินผลคุณสมบัตiteknikวิเคราะห์สัมารับห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ตีรธรรมสาร, ๒๕๒๙.๖๗-๑๘๕